



สจ.ยะลา
เลขที่รับ 9790 เวลา 10.50
ลงวันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๘

ที่ สร ๐๙๒๒.๐๕/ว ๒๑๖๗

ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา

๙๕ เทศบาล ๑ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

๙๕๐๐๐

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การรับบริการทางห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม

เรียน ท่านผู้อำนวยการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการขอรับบริการ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา ได้ให้บริการทางห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (น้ำดื่ม) และชุดทดสอบภาคสนามสำหรับตรวจเชื้อแบคทีเรียด้านวิธีการ เทียบสี (อ.๑๑ และ อ.๑๓) โดยมีอัตราค่าบริการตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเสาวคนธ์ ภักดี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

โทร. ๐ ๓๓๒๑ ๒๘๖๐

โทรสาร ๐ ๓๓๒๑ ๓๓๔๗ PC๒๑๘/๔๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง hpc12@anamai.mail.go.th

บัญชีรายชื่อแนบท้ายหนังสือ ที่ สธ ๐๙๒๒.๐๕/ว ๒๑๖๗ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, สงขลา, สตูล, พัทลุง, ตรัง

ปลัดจังหวัดจังหวัดยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, สงขลา, สตูล, พัทลุง, ตรัง

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, สงขลา, สตูล, พัทลุง, ตรัง

ท้องถิ่นจังหวัดยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, สงขลา, สตูล, พัทลุง, ตรัง

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕


ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกระบี่ พังงา สตูล

ผู้บัญชาการเรือนจำกลางปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา

>> อัตราค่าบริการชุดทดสอบภาคสนาม

ชุดทดสอบภาคสนาม	ราคา (บาท)
- อ.11 (ตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำบริโภค)	20/ขวด
- อ.13 (ตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร/ ภาชนะ/มือผู้สัมผัสอาหาร)	20/ขวด
- สารละลายบัฟเฟอร์ (สำหรับ อ.13)	20/ขวด

>> ภาชนะสำหรับเก็บตัวอย่างน้ำ (21 พารามิเตอร์)

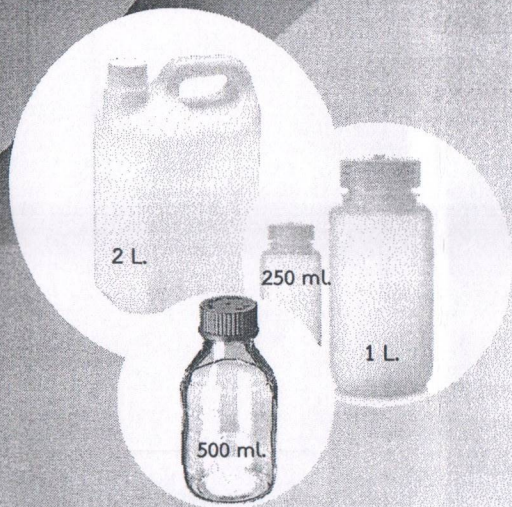

สำหรับตรวจวิเคราะห์ทางเคมี-กายภาพ 2 L.

สำหรับตรวจวิเคราะห์โลหะหนัก 1 L.

สำหรับตรวจวิเคราะห์ไนโตรเจน 250 mL.

สำหรับตรวจวิเคราะห์ทางแบคทีเรีย 500 mL.

** รับภาชนะเก็บตัวอย่างจากห้องปฏิบัติการ **



ID Line : @540gtqfn

แผนกเวชศาสตร์ชั้นสูงตร โรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่ 12
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

เปิดให้บริการ เวลา 08.30 – 16.30 น.

ในวันเวลาราชการ

ติดต่อ : ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา 95 ถนนเทศบาล 1 ต.สะเตง

อ.เมือง จ.ยะลา 95000

โทร : 073-212862 หรือ 073-212860 ต่อ 144 (Lab)

E-mail : labhpc12yala@gmail.com


เว็บไซต์ : <https://hpc12.anamai.moph.go.th>

Facebook : <https://www.facebook.com/HPC12YALA>



ห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนกเวชศาสตร์ชั้นสูงตร โรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่ 12
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

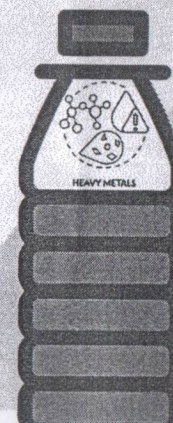

>> ขั้นตอนการให้บริการ

ชำระก่อนรับบริการ/เงิน

ประสานงาน / แจ้งความประสงค์

ชำระเงิน

รับชุดทดสอบ / ภาชนะเก็บตัวอย่างน้ำ*

ส่งตัวอย่างน้ำกลับมายัง ศอ.12*

รับรายงานผลทดสอบจาก ศอ.12*

ชำระหลังรับบริการ

ประสานงาน / ยื่นหนังสือ
(ลงนามผู้มีอำนาจในหน่วยงาน)

รับชุดทดสอบ / ภาชนะเก็บตัวอย่างน้ำ*
พร้อมหนังสือแจ้งราคา

ส่งตัวอย่างน้ำกลับมายัง ศอ.12*

หนังสือแจ้งหนี้

ชำระค่าบริการ

รับรายงานผลทดสอบจาก ศอ.12*


* เฉพาะส่งตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ 21 พารามิเตอร์

เงื่อนไขการนำส่งตัวอย่างน้ำ



1. การตรวจด้านแบคทีเรียจะต้องนำส่งในวันจันทร์และวันอังคารเท่านั้น หรือในวันที่ทางห้องปฏิบัติการกำหนด
2. ห้ามแช่แข็งตัวอย่างน้ำ
3. ตัวอย่างน้ำต้องรักษาที่อุณหภูมิไม่เกิน 6°C
4. เวลาการรับตัวอย่าง 08.30 – 15.00 น. หากนำส่งหลังจากเวลาดังกล่าวให้ถือวันลงรับตัวอย่างเป็นวันถัดไป

>> การบริการ



1. การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (น้ำดี) ทางห้องปฏิบัติการ 21 พารามิเตอร์ ตามประกาศของกรมอนามัย “เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563”
2. ชุดทดสอบภาคสนามสำหรับตรวจเช็คแบคทีเรียด้วยวิธีการเทียบสี ได้แก่ อ.11 และ อ.13

น้ำยาทดสอบภาคสนาม อ.11

> ตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำบริโภค
และน้ำแข็ง



น้ำยาทดสอบภาคสนาม อ.13

> ตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร
> ภาชนะ อุปกรณ์
> มือผู้สัมผัสอาหาร




>> อัตราค่าบริการ

แบบราคาเหมาจ่าย 21 รายการ

- หน่วยงานภาครัฐ 3,500 บาท
- หน่วยงานเอกชน 7,200 บาท

แบบแยกรายการ

รายการทดสอบ	ราคา (บาท)
ด้านกายภาพ	
1. สี (Color)	100
2. ความขุ่น (Turbidity)	250
3. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	200
ด้านเคมีทั่วไป	
4. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS)	250
5. ความกระด้าง (Hardness)	400
6. ซัลเฟต (SO_4^{2-})	650
7. คลอไรด์ (Cl^-)	650
8. ไนเตรท (NO_3^-)	650
9. ไนไตรท์ (NO_2^-)	650
10. ฟลูออไรด์ (F^-)	650
ด้านโลหะหนัก	
11. เหล็ก (Fe)	650
12. แมงกานีส (Mn)	650
13. ทองแดง (Cu)	650
14. สังกะสี (Zn)	650
15. ตะกั่ว (Pb)	650
16. โครเมียม (Cr)	650
17. แคดเมียม (Cd)	650
18. สารหนู (As)	650
19.ปรอท (Hg)	650
ด้านแบคทีเรีย	
20. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform bacteria)	350
21. อี.โคไล (E.coli)	350




การชำระค่าบริการ

ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลาไม่สามารถลงนามในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างได้ สามารถออกได้เพียงหนังสือแจ้งค่าบริการและใบเสร็จได้เท่านั้น

1. ชำระเงินสด / ชำระด้วยตนเอง : ห้องการเงิน
2. ชำระหลังรับบริการ : ยื่นหนังสือขอรับบริการ (ลงนามผู้มีอำนาจในหน่วยงานของท่าน) ก่อนรับบริการ

ขั้นตอนการรับบริการ

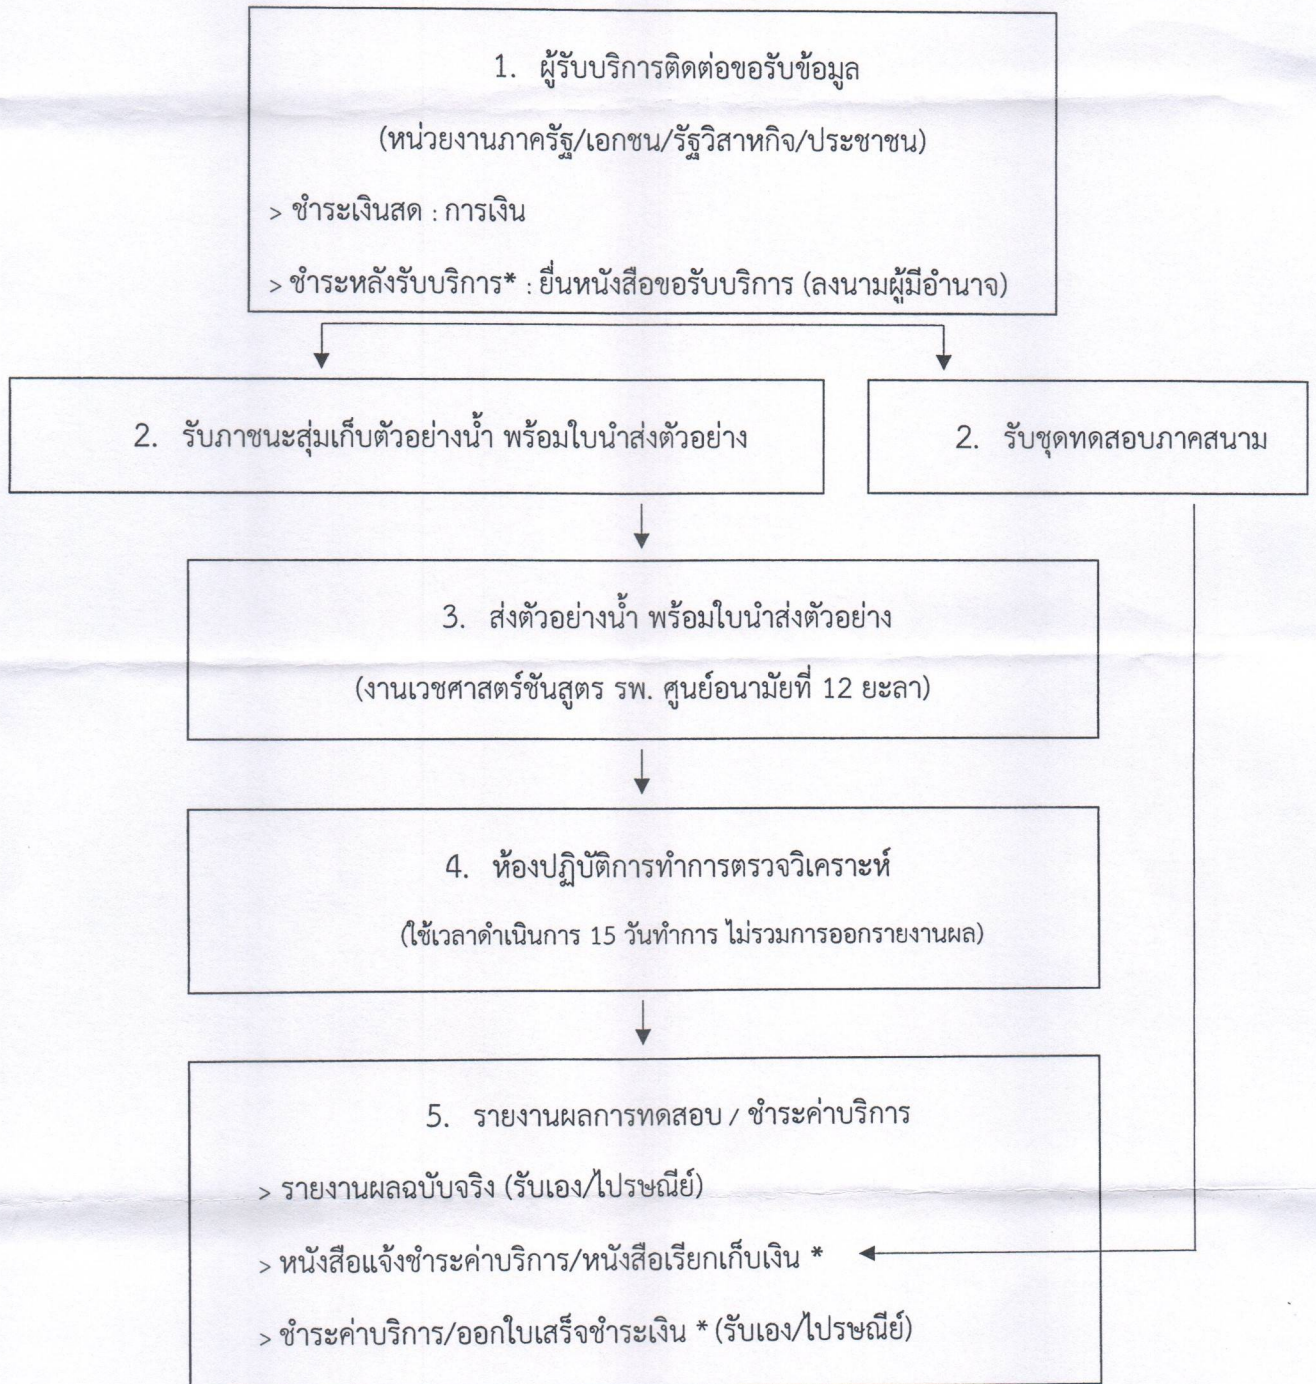

(รวมระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่รับตัวอย่างจนถึงออกรายงานผลทั้งสิ้น 20 วันทำการ)



เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 084-6316984
เจ้าหน้าที่การเงิน 088-7955696